



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.O.T. (AST

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۱۶	۱,۰۶۲	۳۵,۹۱۴	۳۶,۹۷۶	۳۸,۰۳۸	۳۹,۱	۴۰,۱۶۲	۴۱,۲۲۴	۴۲,۲۸۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 1.817	SD: 0.7	Mean: 38.519
------------	---------	--------------

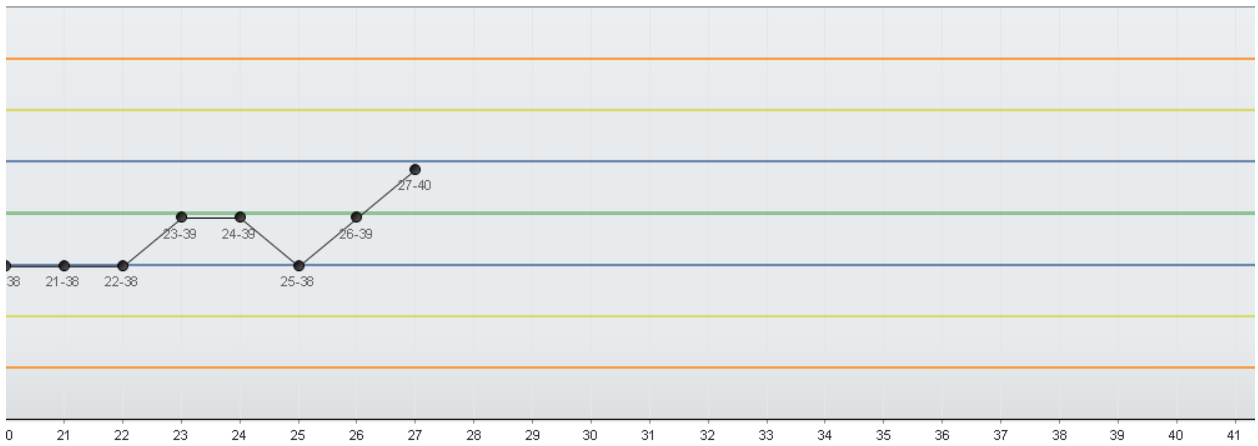

42