



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

HDL Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۹۶۳	۲,۰۶۹	۶۳,۶۲۶	۶۵,۶۹۵	۶۷,۷۶۴	۶۹,۸۳۳	۷۱,۹۰۲	۷۳,۹۷۱	۷۶,۰۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 3.01	SD: 2.113	Mean: 70.185
-----------	-----------	--------------

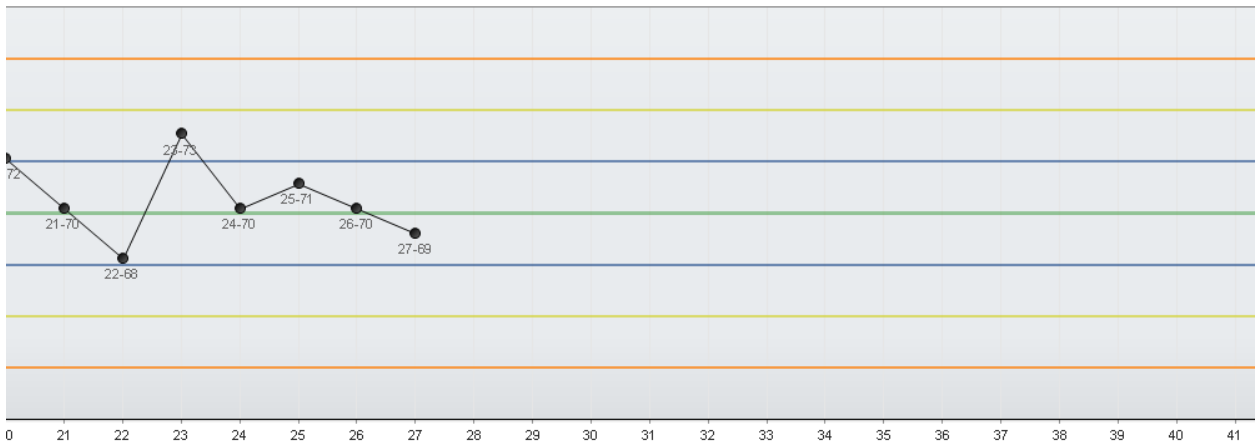

42